



# Annexe 1 : IMPLANTATION DU LBM DU CH VALENCIENNES

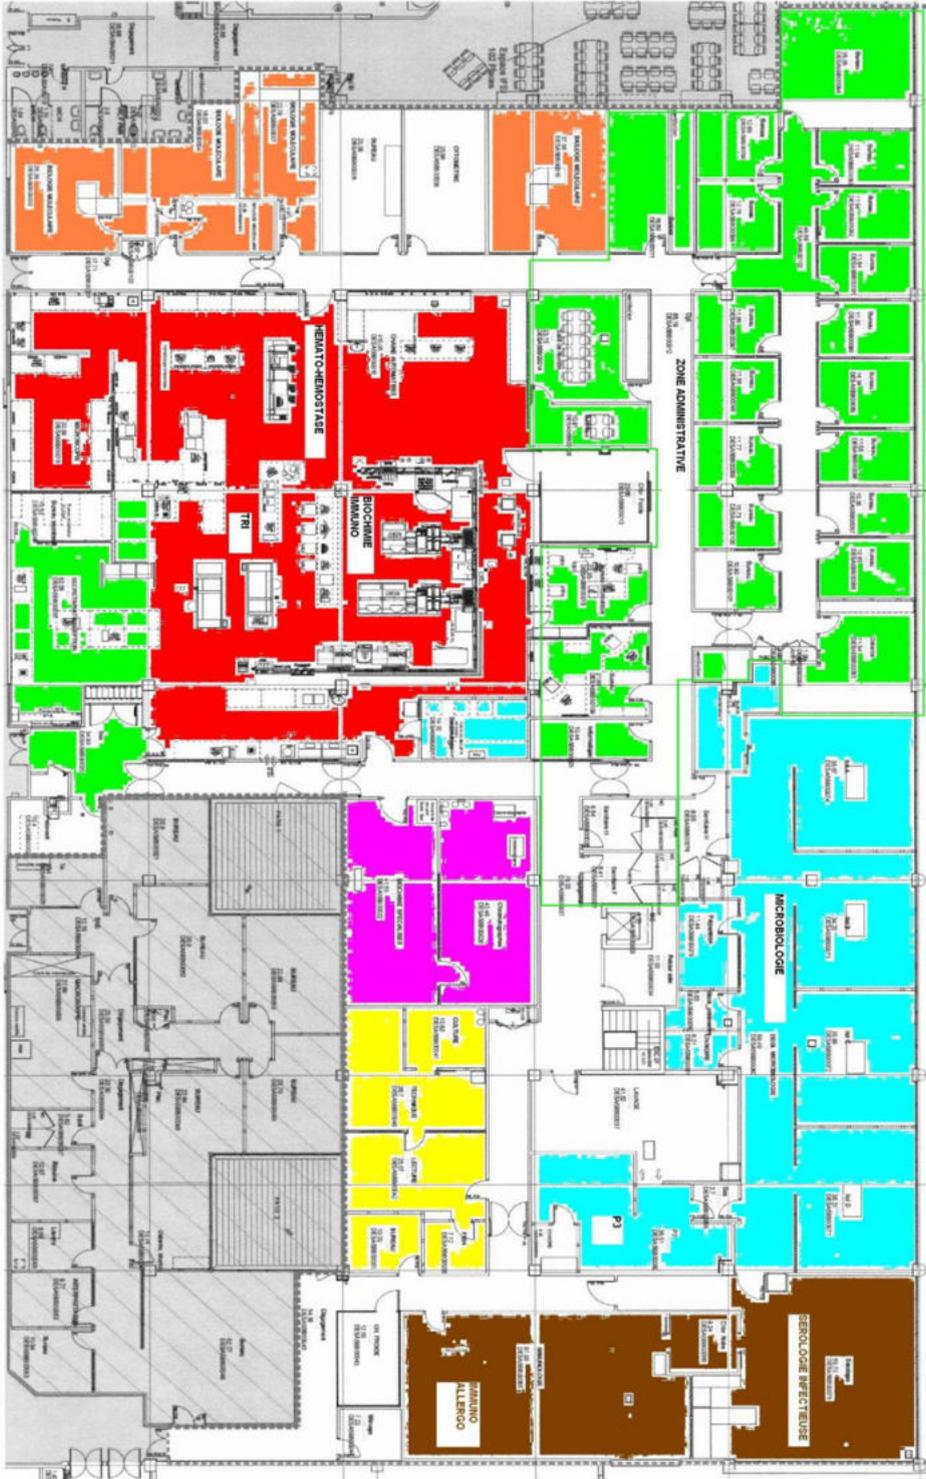

# Annexe 2 : PLAN DES LOCAUX CH DENAIN

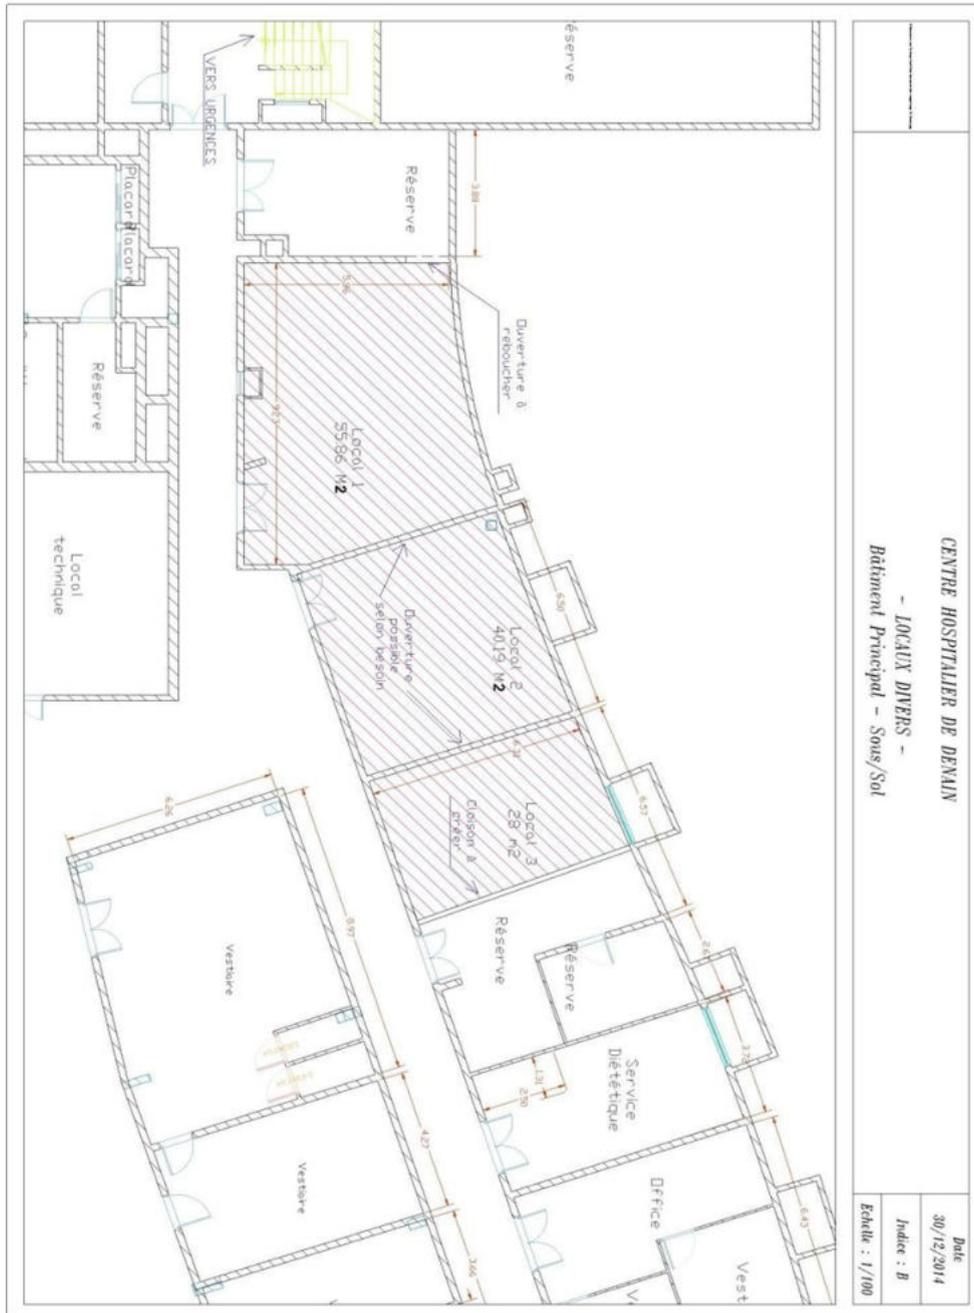

## Annexe 3 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES BESOINS

TABLEAU RECAPITULATIF DES BESOINS TECHNIQUES DU LABORATOIRE							
Type	Dimension	Poids	Alimentation CF	Alimentation Cf	Raccordement eau / effluents	Dégagement calorifique	Implantation
Analyseur de biochimie BECKMAN COULTER AU480	L=145cm P=77cm H=120cm	420kg	<3,5 kVA PAO = 20A 1 PC 10/16A 1PCO 10/16A	2 RJ45	20 L/h	10 870 BTU/h soit 2740 Kcal/h	sol
Station de production d'eau pure LABTOWER 20	L=45cm P=58cm H=150cm	66kg	1 PC 10/16A	NA	eau froide		sol
Station de traitement des effluents TREFFLER ARAVIS	L=36cm P=73cm H=62cm	NC	1 PC 10/16A	NA	eau TH15 mise à l'égout DN40		sol
Analyseur d'immuno-chimie BECKMAN COULTER ACCESS2	L=99cm P=61cm H=47cm	91kg	<1,45 kVA 1 PC 10/16A 1 PCO 10/16A	2 RJ45	NA	2 880 kJ/h soit 690Kcal/h	paillasse
Analyseur d'hématologie SYSMEX XN1000	L=64,5cm P=75,5cm H=85,5cm	78kg	<1,80 kVA 2 PC 10/16A 3 PCO 10/16A	2 RJ45	NA attention rejet des effluents	1 548 kcal/h	paillasse
Analyseur d'hémostase STAGO STA COMPACT Max	L=97cm P=73cm H=70,5cm	140kg	<1,40 kVA 2 PC 10/16A 2 PCO 10/16A	2 RJ45	NA attention rejet des effluents	4 778 BTU/h soit 1204Kcal/h	paillasse
Centrifugeuse HETTICH ROTANTA		140kg	1 PC 10/16A				paillasse
Centrifugeuse autre (récupération)			1 PC 10/16A				paillasse
Etuve type bactériologique			1 PC 10/16A	1 RJ45			paillasse
Armoire froid ventilé positif LIEBHERR LFKV 5410	75 cm 75 cm 165 cm		1 PC 10/16A	1 RJ45			sol
Armoire froid ventilé positif LIEBHERR LFKV 3910	60 cm 60 cm 185 cm		1 PC 10/16A	1 RJ45			sol
Armoire froid ventilé négatif LGN 2323			1 PC 10/16A	1 RJ45			sol
Bain marie			1 PC 10/16A				paillasse
Microscope			1 PC 10/16A				paillasse
Vortex			2PC 10/16A				paillasse
PC (écran + UC) (3) (fourni CH denain)			2PC 10/16A/PC 1 PCO/PC	2 RJ 45/PC			paillasse
Imprimante fax photocopieuse A4 (CH Denain)			1PC 10/16A	2RJ45			sol
Imprimante CaB			1PC 10/16A	1RJ45			paillasse
Téléphones (2 filaires, 1 non filaire)				à définir par Denain			paillasse

Espace détente			5 PC 10/16A				
Bureau médical			4 PC 10/16A				
Gaz du sang (prévision)			2 PC 10/16A 2 PCO 10/16A	2 RJ45			

[Aide à la rédaction d'un rapport de stage](#)  
[Annexe dans un rapport de stage](#)